molten®
From the Inside Out

スライディングボード イージーモーション Sタイプ

取扱説明書

目　次

○注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・P1
○各部名称・・・・・・・・・・・・・・・・P1
○イージーモーションSタイプを使った移乗方法 P1
○お手入れ方法・・・・・・・・・・・・・・P3
○仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・P3

安全にご使用いただくために

必ず医師や看護師などの専門員とご相談の上ご使用ください。

この度は当社製品をお買い求めいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後もいつでも見られる場所に大切に保管してください。ご本人の健康状態や床ずれが変化した場合には医師や看護師などの専門員に相談し、適切な処置を受けてください。

安全上のご注意 必ずお守りください

●ご本人や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
取扱説明書に表示されている記号および言葉は、表示内容を無視した誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次のような表示区分で表しています。

⚠ 警告：死亡または重傷などを負う可能性がある場合。

⚠ 注意：障害を負う可能性または物的損害を発生させる可能性がある場合。

注意：本製品の故障を防止するための注意事項や、より快適にご使用いただくためのアドバイスが書かれていることを意味します。

●お守りいただく内容の種類を次の表示で区分して表しています。

⃠ この絵表示は、してはいけない「禁止」の意味です。

❗ この絵表示は、必ず実行していただく「強制」の意味です。

用　途

●安全にスムーズな移乗を支援するボードです。
（安全に使用するために専門家などにご相談･指導を受けてください。）

●ベッドから車いすなどへの移乗時にご使用ください。

●表面は滑り特性があり、裏面には滑り止めシートを標準装備しています。
（ボードを引抜く際にクッションやシーツなどを傷めない素材にしています。）

●しなりのある素材を使用し、折れ曲がりにくく耐久性にも優れています。
（耐荷重130Kg）

注意事項

警　告

- ●安全に使用するために専門家などにご相談･指導を受けてください。
- ●座位が保持出来ない方の使用は、専門家などにご相談･指導を受けてください。
- ●肘掛けが上がらない車いす、肘掛けが取り外せない車いすでは転落の恐れがあるので使用しないでください。
- ●使用前には破損･ひび割れなどや白化が無いことを確認し、発見した場合は絶対に使用しないでください。
- ●ベッド･車いすなどへの移乗時には必ず車いすのストッパーをかけ、動かないようにしてください。
  ベッド･車いすの移乗は高さを同じにするか、移乗先を少し(5cm以内)低くすると移乗がしやすくなります。
- ●ボードの両端がベッドや車いすに15cm以上掛かるように設置してください。
- ●移乗は、ご本人がしっかりボードに座っているのを確認してください。
- ●体重が130kg以上の方は使用しないでください。
- ●直接皮膚が触れた状態でボード上を移動するとケガをする恐れがありますので、必ず衣類などを着用して使用してください。
- ●移乗以外の用途には使用しないでください。
- ●本製品は日本国内専用です。海外では使用できません。

各部名称

表面　表面を上にしてお使いください。

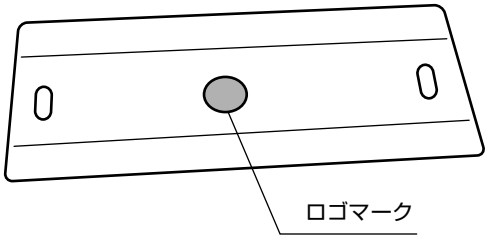

裏面

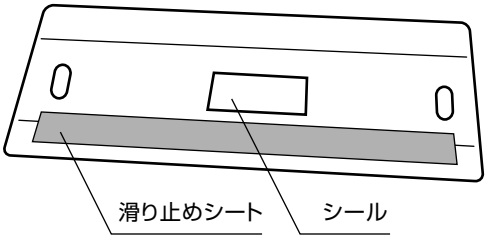

イージーモーションSタイプを使った移乗方法（基本）

ベッドから車いすへ

介助あり／肘掛けが跳ね上がる車いす

⃠ 肘掛けが上がらない車いす、肘掛けが取り外せない車いすには使用しないでください。

1　ベッド上で上半身を起こします。

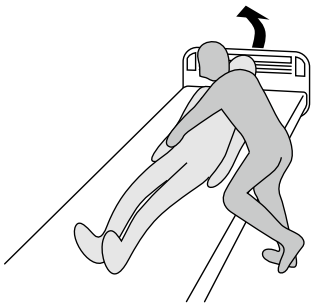

2　ベッドに端座させます。

3　車いすをベッド脇に持ってきます。

移乗させやすいよう
できるだけ車いすを
ベッドに近づけます。

⚠ **注意**　●車いすは必ずストッパーをかけ、ベッド側のフットレストを外して反対側の足置きを上げてください。

イージーモーションSタイプを使った移乗方法（基本）

4 ベッドに端座させた状態でイージーモーションSタイプの端をおしりの下に挿入し、反対端を車いすの座面に乗せます。

ベッドおよび車いすの座面にしっかりと(15cm以上)乗るように設置ください。

ご本人の足を端座位置と車いす着座位置の中間に置いてください。

設置状態を上から見た図

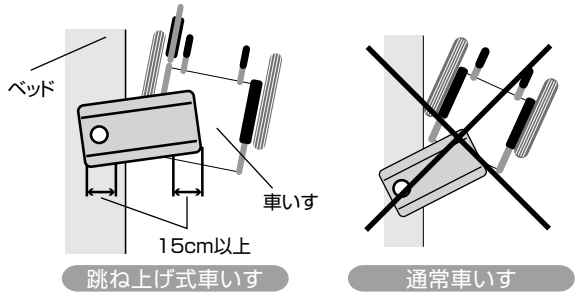

肘掛けが上がらない車いす、肘掛けが取り外せない車いすには使用しないでください

5 ご本人の腰をしっかり持ち、体重をイージーモーションSタイプに乗せるようにしながら車いす側に体を移動させます。

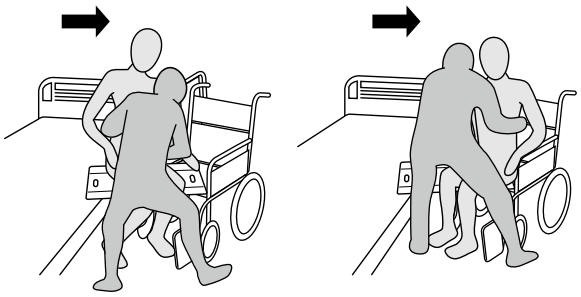

ご本人がしっかりボードに座っているのを確認してください。

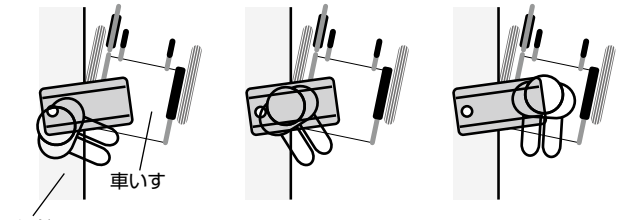

移乗時の人の動きを上から見た図

6 車いすに完全に乗った状態でイージーモーションSタイプを介助者が抜き取ります。姿勢を整えて移乗完了です。

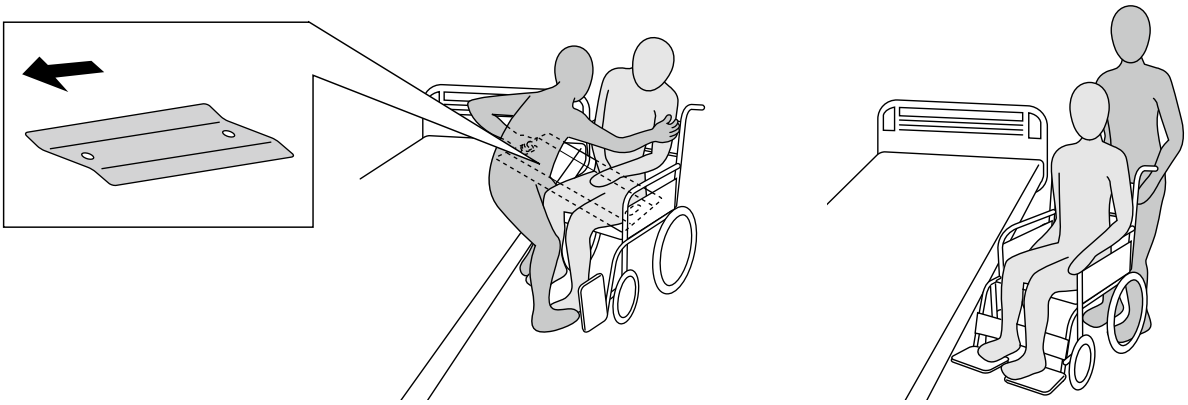

介助なし／肘掛けが跳ね上がる車いす

肘掛けが上がらない車いす、肘掛けが取り外せない車いすには使用しないでください。

1 ベッドに端座します。

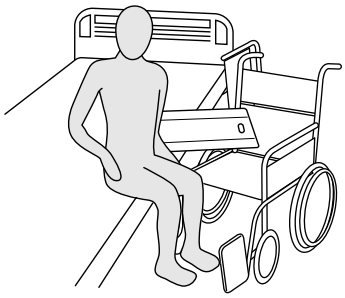

イージーモーションSタイプの端をおしりの下に挿入し、反対端を車いすの座面に乗せます。

⚠ 注意

- 車いすは必ずストッパーをかけ、ベッド側のフットレストを外して反対側の足置きを上げてください。

2 車いす側に移動します。

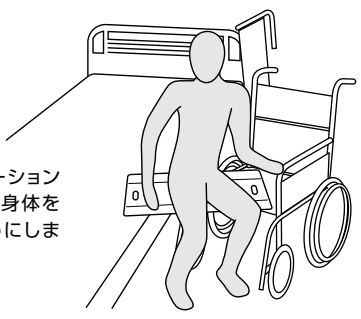

イージーモーションSタイプ上で身体を滑らせるようにします。

車いすに完全に乗った状態でイージーモーションSタイプを抜き取ります。

お手入れ方法

●洗　浄

市販の中性洗剤またはアルコールを布などに含ませて汚れを取り除いてください。

⃠ シンナー･ベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。
⃠ 酸性洗剤は使用しないでください。

●消　毒

消毒液やアルコールを噴霧または布に染み込ませて拭き取ってください。

⃠ 消毒液はメーカー指定の希釈倍率で使用してください。
⃠ 原液のまま使用すると表面が劣化する恐れがあります。
⃠ 有機溶剤(シンナー、ベンジンなど)は使用しないでください。

消毒装置を使用する場合は温度80℃以下、2時間以内の設定にし、製品は必ず平らな状態にしてください。斜めに立てかけると変形します。

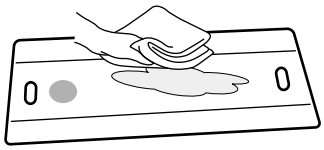



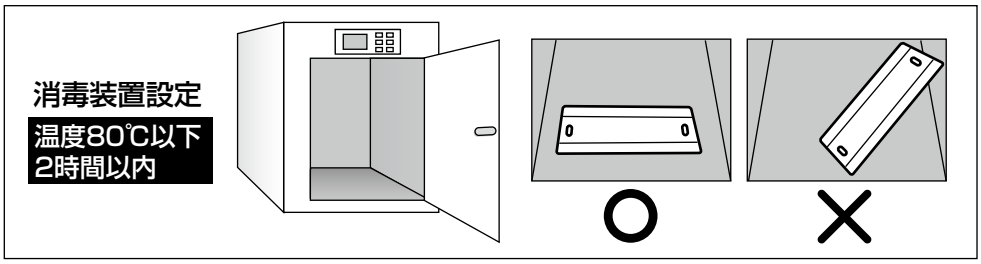

仕 様

イージーモーション Sタイプ　品番　MEMSQ

●サイズ：幅35.6cm×長さ59cm×厚さ0.5cm
●重　量：1.0kg
●材　質：ポリプロピレン(滑り止めシート付き)
●耐荷重：130kg

開発・製造元

株式会社 モルテン
健康用品事業本部
www.molten.co.jp/health
東京　札幌　仙台　名古屋　大阪　広島　福岡
製品他、各種お問い合せは
〒739-1794　広島市安佐北区口田南2-18-12
TEL.082-842-9975
FAX 0120-769-123
E-mail:health@molten.co.jp

※ 健康用品事業本部にて取得しています。

2015.10